

Koszalin, 21.07.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym nr TP.382.080.2026 MB – Materiały eksploatacyjne na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Okulistyki

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy części nr 10, poz. 1:


„Proszę o podanie wymiarów etykiet, ile etykiet na 1 rolce, jakie fi?”

ODPOWIEDŹ:

Wymiary etykiety: 101x56 mm, liczba etykiet na rolce: 2000 sztuk, fi zgodne z posiadają przez Zamawiającego drukarką, model Zebra S4M typu Sandwich, kompatybilna z systemem T-DOC.

Pozostałe parametry opisane w SWZ pozostają bez zmian.

Poniżej wzór oraz wymiary etykiet używanych obecnie przez Zamawiającego:

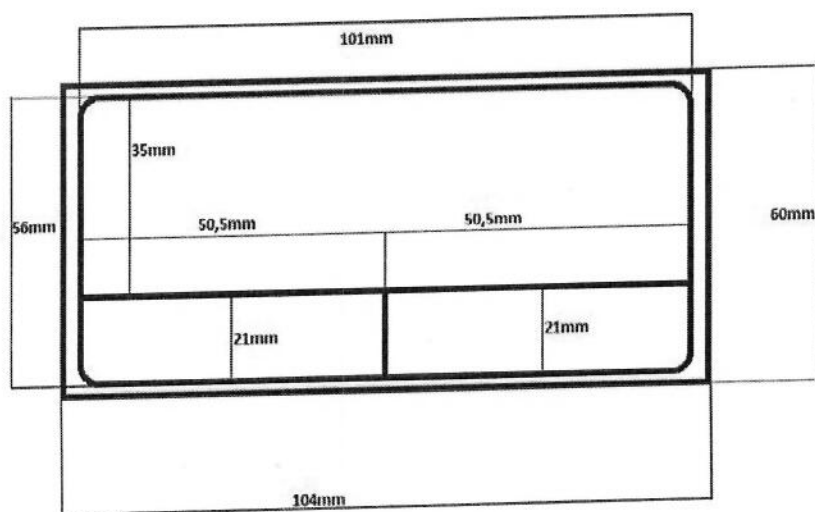

PYTANIE NR 2 dotyczy części nr 10, poz. 4:

„Proszę o podanie modelu ze wskazaniem numeru katalogowego lub parametrów technicznych skanera.”

ODPOWIEDŹ:

Skaner datologiczny POWER SCAN zgodny (odpowiednie oprogramowanie) do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem dokumentacji narzędzi T-DOC. Wymagana wersja oprogramowania sprzętowego skanera gwarantująca działanie systemu T-DOC.

Pozostałe parametry dotyczące skanera są opisane w Załączniku nr 2 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

PYTANIE NR 3 dotyczy części nr 18, poz. 1 oraz projekt umowy, § 6 ust. 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kasety z 6-miesięcznym terminem ważności od daty dostawy?”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4 dotyczy części nr 9, poz. 1:
„Czy w miejsce rękawa o szerokości 50mm Zamawiający dopuści rękaw 55mm?”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5 dotyczy części nr 9, poz. 4:
„Czy w miejsce rękawa o szerokości 125mm Zamawiający dopuści rękaw 120mm?”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6 dotyczy części nr 9:
„Czy Zamawiający dopuści rękawy grzewalne w temperaturze 170-200°C?”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 7 dotyczy części nr 9:
„Czy Zamawiający dopuści rękawy o okresie ważności – 2 lata od daty produkcji?”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8 dotyczy części nr 12, poz. 1-2:
„Czy Zamawiający dopuści: „Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/ zabicie bakterii po 20 minutach inkubacji. Wskaźnik aktywowany poprzez rozkruszenie w specjalnej kruszarce dołączonej do każdego opakowania bądź we wbudowanej w autoczytnik kruszarce. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Kształt fiolki w kształcie litery „O”, dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze błękitnym. Na fiolce repozycjonowalna nierwająca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Wykonawca nieodpłatnie użyje autoczytnik kompatybilny z oferowanymi testami. Pakowany po 50 sztuk.”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 9 dotyczy części nr 12, poz. 4:
„Proszę o podanie Czy Zamawiający dopuści: „Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji plazmowej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/ zabicie bakterii po 30 minutach inkubacji. Wskaźnik aktywowany poprzez rozkruszenie w specjalnej kruszarce dołączonej do każdego opakowania bądź we wbudowanej w autoczytnik kruszarce. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Kształt fiolki w kształcie litery „O”, dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze szarym. Na fiolce repozycjonowalna nierwająca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Wykonawca nieodpłatnie użyje autoczytnik kompatybilny z oferowanymi testami. Pakowany po 50 sztuk.”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 10 dotyczy części nr 14, poz. 2:
„Czy Zamawiający dopuści testy posiadające spodnią warstwę w kolorze srebrnym?”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 11 dotyczy części nr 9:
„Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rękawów grzewalnych w temp. 180-220 ° C. Ze względu na dużą różnorodność grzewarek na rynku, gdzie grzewy zamykające wytwarzane są w różnoraki sposób – dopuszcza się możliwość uzyskania prawidłowego grzewu zamykającego w temperaturze od 160° C.”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza rękawy grzewalne w temperaturze 180-220° C.

PYTANIE NR 12 dotyczy części nr 17:

„Czy zamawiający zgodzi się na przedstawienie oświadczenia producenta lub certyfikat badań z jednostki niezależnej potwierdzające szczelność mikrobiologiczną w miejsce certyfikatu producenta?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 13 dotyczy części nr 17, poz. 7-8:

„Czy zamawiający dopuści opakowanie a'500 szt.? Ze względu na fakt, że jest to mały rozmiar papieru (60 cm x 60 cm) większa ilość arkuszy nie wpływa na wagę opakowania.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 14 dotyczy części nr 19:

„Czy zamawiający zgodzi się na rękawy zgrzewalne w temperaturze 105-125 st.C?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza rękawy zgrzewalne w temperaturze 105-125° C.

PYTANIE NR 15 dotyczy części nr 19:

„Czy zamawiający dopuści rękaw o gramaturze tyvec 64,5 g/m2 + folia 55,7 g/m2, co daje w sumie 120,2 g/m2?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Dział Zamówień Publicznych
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
Piotr Gaska
mgr Piotr Gaska